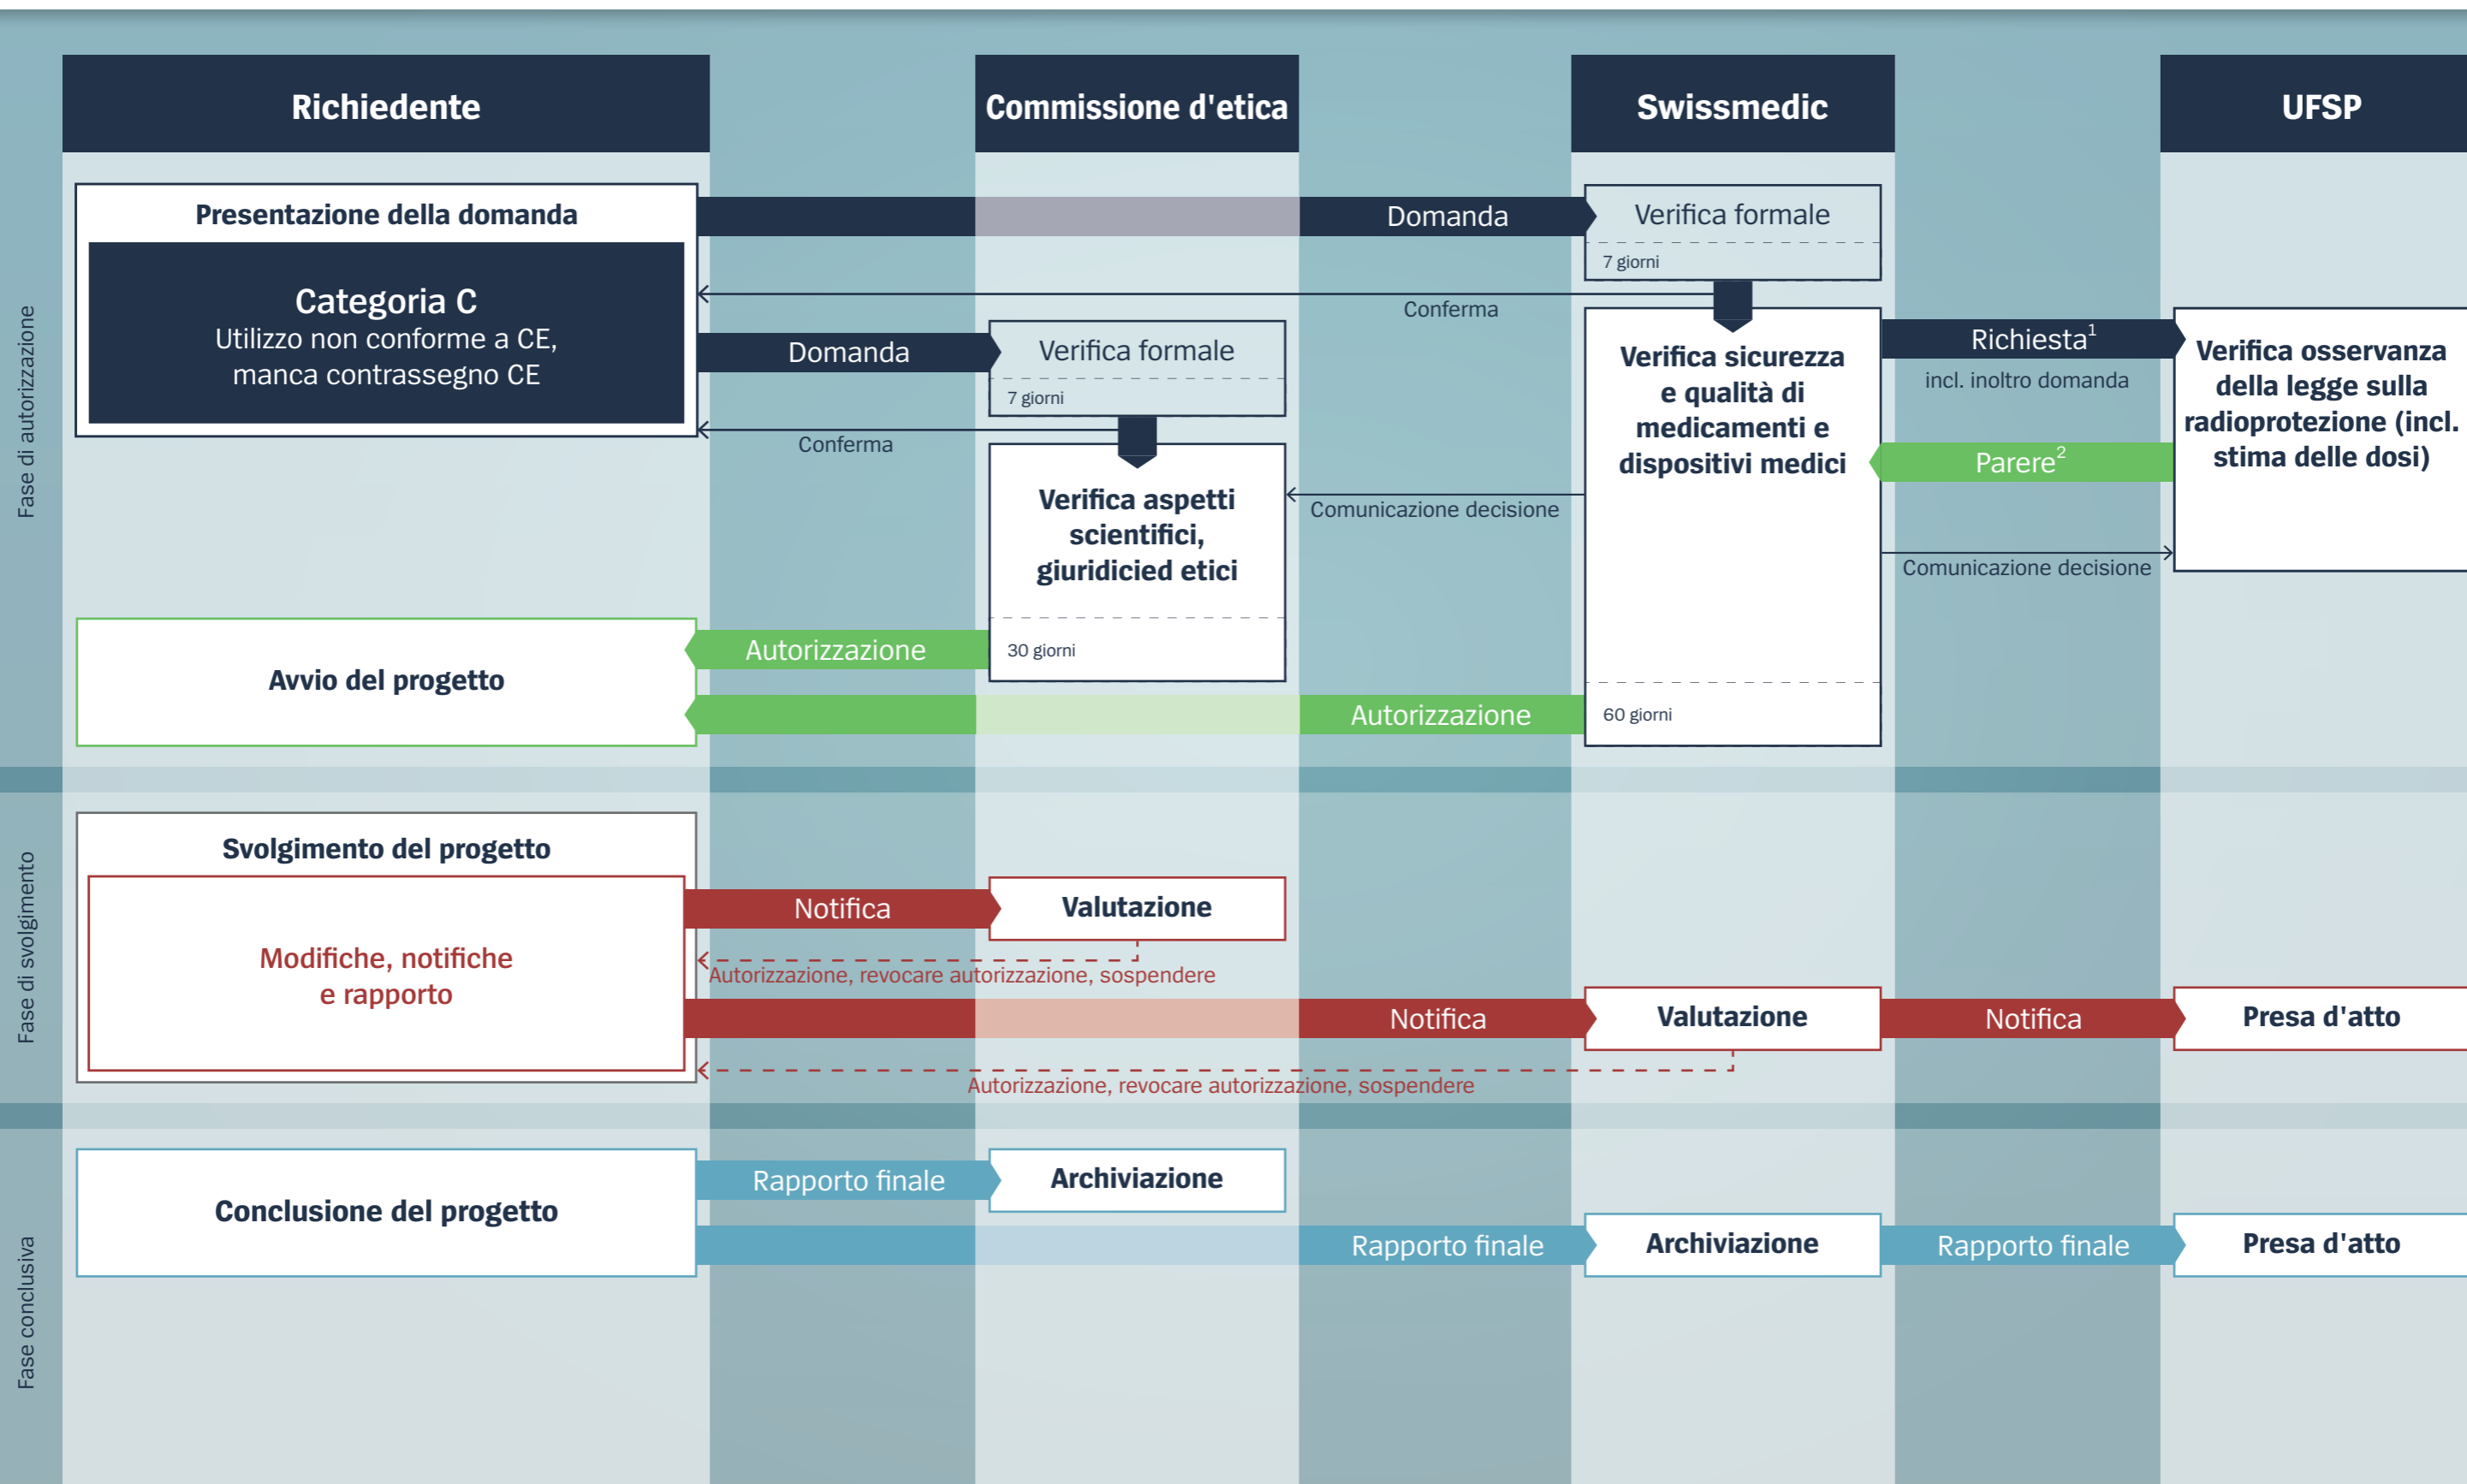


Svolgimento per:

Sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici che possono emettere radiazioni ionizzanti

Sorgente radioattiva come componente di un dispositivo medico

Sperimentazioni della categoria C

**Testi di legge rilevanti:**

Fase di autorizzazione
art. 24–26, 31, 33, 36 OSRUm, allegato 4 n. 5 OSRUm
art. 28 ORaP (valori limite di dose)

Fase di svolgimento
art. 36, 41, 42 OSRUm

Fase conclusiva
art. 36, 38 OSRUm

¹ Per l'autorizzazione Swissmedic chiede il parere dell'UFSP

² Secondo l'articolo 36 OSRUm Swissmedic rilascia l'autorizzazione se l'UFSP non ha presentato obiezioni.